

Bedienungsanleitung - Pflegesessel mit Aufstehhilfe Naron Lift 2 -



Made in Germany

Hersteller

Devita GmbH
Poststr. 11
D 66649 Oberthal
Tel. 06854 – 80 30 81
Fax.06854 – 80 30 83
e-mail: info@devita-online.de

Stand 04/2020

Inhaltsübersicht

1	Vorwort	3
2.	Kontrolle der Lieferung	4
2.1	Lieferumfang	4
2.2	Transportschaden	4
3	Sicherheitshinweise	4
3.1	Anmerkungen für die Benutzung	5
3.2	Gewährleistungen für einen sicheren Betrieb	5
4	Technische Daten	6
4.1	Maße	6
4.2	Technische Daten Antrieb Aufstehhilfe	6
4.3	Elektroversorgung	7
5	Warn- und Hinweisschilder	7
6	Handhabung	8
6.1	Allgemeines	8
	- Versenken der Armlehnen	8
	- Handhabung bei manueller Verstellung	8
	- Feststellen der Schwenkrollen	8
6.2	Akku (optional)	
	- Fehlerbehebung für den Akku	10
7	Pflege, Wartung und Entsorgung	11
7.1	Entsorgung	11
7.2	Zusatzinformationen	12
8	Artikelkennzeichnung	13
9	Übersicht zu den Ersatzteilen	13
10	Gewährleistung und Haftung	14
10.1	Gewährleistung	14
10.2	Haftung	14
11	Konformitätserklärung	14

1. Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen DEVITA Pflegesessels mit Aufstehhilfe. Sie haben ein qualitativ hochwertiges, zuverlässiges und dem neuesten Stand der Technik entsprechendes Produkt aus dem Hause DEVITA erworben. Mit dem DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe werden Sie die vielen Vorteile, die Ihnen dieser Sessel im Alltag ermöglicht, bald genießen. So zum Beispiel:

- **Arbeitserleichterung für Pflegekräfte und Benutzer**
Weniger „Umsetzen“, da der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe ein Multifunktionsessel für Ruhen, Schlafen, Fernsehen und Essen ist – ALLES IN EINEM und das mit bester Ergonomie.
- **Wohnlichkeit und Hygiene**
Die große Auswahl an warmen Holzfarben und Stoffen integriert Ihren DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe optimal in Ihre gewohnte Wohnsituation.
Die Bezugstoffe sind hygienisch einwandfrei, leicht zu reinigen und auch abwaschbar.
- **Komfort und Ergonomie**
Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe ist so konstruiert und entwickelt, dass er den ganzen Tag einen bequemen Komfort bietet, speziell für Personen, die den kompletten Tag sitzend oder liegend verbringen. Das umfangreiche Zubehör unterstützt den Komfort zusätzlich
- **Mobilität im ganzen Haus**
Der Schiebegriff am Rücken und die großen Schwenkrollen ermöglichen es, die im Sessel sitzende Person im ganzen Haus leicht zu schieben – die Mobilität bleibt sogar mit der Aufstehhilfe erhalten.

Bitte nehmen Sie sich zuerst etwas Zeit, die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung zu lesen, um so den Sessel und seine Funktionen näher kennen zu lernen.

Sollten Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne hilfreich zur Seite.

Wir wünschen Ihnen viel Freude,

Ihr DEVITA-Team

Händlerstempel

Ort, Datum

2. Kontrolle der Lieferung

Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe wird Ihnen von Ihrem Fachhändler in gebrauchsfähigem Zustand angeliefert. Es erfolgt eine erste Einweisung in die Bedienung. Die Kontrolle der Lieferung hat also Ihr Fachhändler schon durchgeführt. Sollten Sie einen anderen Weg der Zustellung gewählt haben, empfehlen wir Ihnen, die Lieferung wie folgt zu kontrollieren:

2.1 Lieferumfang

Vergleichen Sie Ihre Bestellung mit der empfangenen Lieferung. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren zuständigen Ansprechpartner.

2.2 Transportschaden

Ein Transportschaden soll nicht Ihr Schaden sein! So verhalten Sie sich im Schadensfall richtig:

Wenn die Verpackung beschädigt ist – in Gegenwart des anliefernden Unternehmens sofort auspacken und den Schaden auf dem Frachtbrief bescheinigen lassen. Anschließend das Transportunternehmen verständigen.

Wenn die Verpackung in Ordnung, der Inhalt aber beschädigt ist – sofort das anliefernde Transportunternehmen schriftlich verständigen und eine Besichtigung beantragen. Eine Bescheinigung des Schadens auf dem Frachtbrief vornehmen lassen.

Die Meldefrist für einen Transportschaden beträgt bei Speditionen 7 Tage. Bei Nichtbeanstandung entfällt die Ersatzpflicht des Transportunternehmers.

3 Sicherheitshinweise

Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe wurde in Übereinstimmung mit nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert und getestet und wird gemäß den gültigen Richtlinien produziert. Hierdurch wird die vom Hersteller zu leistende Gerätesicherheit erbracht.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und machen Sie sich mit den wichtigsten sicherheitstechnischen Hinweisen vertraut, bevor Sie den DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe in Gebrauch nehmen.



Sicherheitshinweise sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet und verlangen Ihre besondere Aufmerksamkeit!

3.1 Anmerkungen für die Benutzung

Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe wurde als Ruhe- und Entspannungsmöbel entwickelt. Er ist ausschließlich für den Einsatz in Gebäuden und bei normalen Umgebungsverhältnissen vorgesehen. Er darf aus Sicherheitsgründen nur von Personen bedient werden, die

- in seine Handhabung eingewiesen wurden bzw. die Bedienungsanweisung komplett gelesen haben
- körperlich und geistig in der Lage sind, den DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe in allen Betriebssituationen sicher zu bedienen.

Bestimmungsgemäßer Einsatz:

- in Senioren- und Pflegeheimen
- Pflegeeinrichtungen
- Krankenhäusern und Hospitälern
- Rehasentren
- Arztpraxen
- im häuslichen Bereich

NICHT bestimmungsgemäßer Einsatz:

- Duschstuhl
- Toilettenstuhl
- Steighilfe
- Arbeitsstuhl

Die Einweisung in die Bedienung des DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe ist Bestandteil des Lieferumfanges und erfolgt bei Lieferung durch einen DEVITA Händler oder DEVITA Mitarbeiter. Es entstehen Ihnen hierbei keine zusätzlichen Kosten. **Bei Anlieferung über eine Spedition gilt diese Bedienungsanleitung als Einweisung → Bitte sorgfältig durchlesen!**

Bitte beachten Sie:



Bei dem DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe und dem gleichzeitigen Einsatz von höchst-empfindlichen Messgeräten bei eingestecktem Netzstecker kann eine Verfälschung der Messergebnisse nicht ausgeschlossen werden!

Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe muss immer in einwandfreien und funktionstüchtigen Zustand gehalten werden. Wenn ein Mangel auftritt, den Sie nicht beherrschen können, dürfen Sie den DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe nicht benutzen. Kennzeichnen Sie den Stuhl als nicht funktionstüchtig und verständigen Sie unseren Service.

3.2 Gewährleistungen für einen sicheren Betrieb

Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe ist vor dem ersten Gebrauch und weiterhin bei Bedarf zu reinigen ggf. zu desinfizieren.
- Alle Befestigungselemente, auch an Zubehörteilen, müssen vor dem Gebrauch fest angezogen sein.
- Bei der elektrischen Ausführung mit Netzteil ist vor dem Verschieben unbedingt der Netzstecker zu ziehen.
- Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe darf nicht in einer Waschanlage oder mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Auch das Abspritzen mit einem Wasserstrahl ist nicht gestattet.

4 Technische Daten

4.1 Maße

Sitzbreite:	ca. 53 cm
Sitztiefe:	ca. 52 cm
Sitzhöhe (Standard):	ca. 48 cm
Außenmaße (ohne Zubehör):	
Breite:	ca. 71 cm
Höhe:	ca. 125 cm
Tiefe:	ca. 80 cm
Höhe Armlehne (3-stufig):	ca. 67 cm
Rollendurchmesser:	Ø 100 mm
Gesamtgewicht:	ca. 52 kg
Zulässige Höchstbelastung	140 kg

4.2 Technische Daten Antrieb Aufstehhilfe

Antrieb:	Limoos
Betriebsart:	Aussetzbetrieb 2min/18min
Nennspannung:	18-35V DC
Stromaufnahme:	max. 5A
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	II



Aussetzbetrieb bedeutet, dass die Motoren nach 2-minütiger Belastung unter Nennlast eine Pause von 18 Minuten benötigen.

Rückenmotor MD125-55-L3-468-60:

Max. Kraft: 2,5 KN

Beinmotor MD125-65-L2-270-118:

Max. Kraft: 2 KN

Aufstehmotor MD121-04-L3-235-80:

Max. Kraft: 3 KN

Steuerungen MC120-29V2A Teil Nr: 500009

Umgebungsbedingungen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch: +10°C bis +30°C
20% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit

Input:	100-240V ; 50/60 Hz ; 1,6A
Output:	29V ; 2A
Betriebsart:	Aussetzbetrieb 2min/18min

4.3 optionaler Akku ZB-B1800 Teil Nr: 500703

Eingangsspannung	24V -35VDC
Ausgangsspannung	25.2 V 1800mAh
Ausgangsstrom	max. 5 A (AB 2 min./18 min. zulässig)
Kapazität	1,8 Ah
Energieinhalt	45 Wh
Schutzart	IP20
Akku Typ	Li/Ion
Ladezeit	ca. 6 - 8 Std. (abhängig vom Ladezustand)
Lebensdauer des Akkus	ca. 500 Ladezyklen (abhängig von der Akku-Pflege)
Farben	schwarz RAL 9005
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	150 mm x 90 mm x 40 mm
Umgebungsbedingungen	Raumtemperatur von +10° bis +40°C Rel.Luftfeuchte von 30% bis 75%
Sicherheit	automatische Ladeschaltung, Überlastschutz, kurzschlussfest Akustische Warnung bei geringer Restladung

5 Warn- und Hinweisschilder

Warn- und Hinweisschilder befinden sich an folgenden Stellen:

- **Artikelkennzeichnung inkl. CE-Kennzeichen** ist unterhalb der Sitzfläche angebracht.
- **Zulässige Höchstbelastung 140 kg**
- **Typenschilder** mit entsprechenden Daten auf allen elektrischen Bauteilen

Beachten Sie bitte die Warn- und Hinweisschilder! Sollten Sie feststellen, dass eines dieser Schilder an Ihrem Gerät fehlt oder unleserlich geworden ist, setzen Sie sich mit Ihrem Ansprechpartner in Verbindung. Er liefert Ihnen Ersatz.

6 Handhabung


6.1 Allgemeines

Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe ist ein 3-motoriges Modell, sodass das Beinteil unabhängig vom Rückenteil verstellt werden kann. Hierfür die entsprechende Taste (1) an der Handbedienung solange gedrückt halten, bis die gewünschte Position des Beinteils erreicht ist. Beim Zurückfahren des Beinteils geht der Sessel in die Aufstehfunktion über, wenn der Taster gedrückt bleibt. Der Rücken bewegt sich je nach der gedrückten Taste nach vorne oder nach hinten. Hierbei gibt es eine netzabhängige und eine netzunabhängige Variante mit Akku.

- **Versenken der Armlehnen**

Bei dem DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe können beide Armlehnen in drei vorgegebene Positionen verstellt bzw. versenkt werden.

Hierfür den Arretierknopf (2) nach innen drücken und die Armlehne in die gewünschte Position bringen:

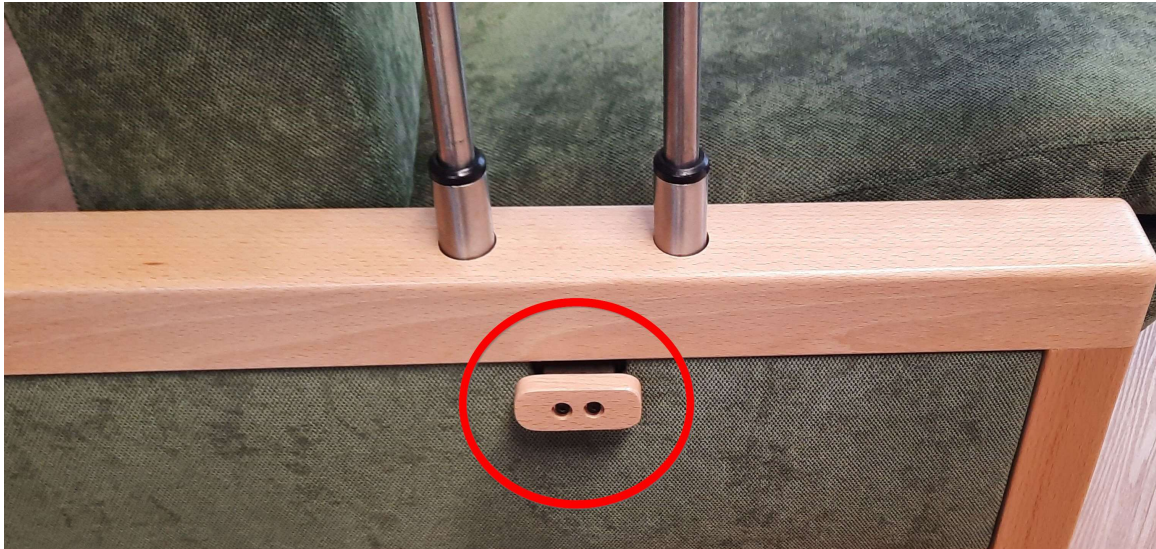

- **Handhabung des Handschalters**



Stufenlose Verstellung
Beinteil

stufenlose Verstellung
Rückenteil

stufenlose Verstellung
Aufstehhilfe

- **Feststellen der Schwenkrollen**

Der DEVITA Pflegesessel ist mit vier einzelnen Rollen (D = 100mm) ausgestattet. Die hinteren Schwenkrollen können durch den Feststeller blockiert werden. Die vorderen sind feststehende Rollen (Bockrollen), die nicht schwenkbar sind.



Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe darf nicht an Rampen oder Schrägen abgestellt werden. Die hinteren Schwenkrollen sind im Stand unbedingt, nach hinten ausgerichtet, zu blockieren – GEFAHR des plötzlichen Wegrollens!



Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe ist nur für den Einsatz innerhalb von Gebäuden und für normale Umgebungsverhältnisse hergestellt.



Bei einer Person, die einer besonderen Beachtung bedarf, ist durch eine Hilfsperson sicherzustellen, dass sich diese besondere Personengruppe (u.a. Kinder, Behinderte, ältere Menschen) nicht durch den Gebrauch des Sessels verletzen kann.



Bitte beachten Sie, dass alle Befestigungselemente, auch die des Zubehörs, vor jedem Gebrauch auf festen Sitz zu überprüfen sind.

Beim Ein- und Ausstieg muss der Pflegesessel immer in Grundstellung gebracht werden. Die Bedienung des Pflegesessels darf nur durch eine eingewiesene Person erfolgen.



Aussetzbetrieb bedeutet, dass die Motoren nach 2-minütiger Belastung unter Nennlast eine Pause von 18 Minuten benötigen.

Der DEVITA Pflegesessel mit Aufstehhilfe kann mit verschiedenem Zubehör bestellt oder teilweise nachträglich ergänzt werden.


6.2 Akku (optional)

1. Der Akku ist im Rücken montiert und gebrauchsfertig.
2. Das Netzkabel mit Trafo wird zum Laden des Akkus mit dem Sessel verbunden. Das Ladekabel am Sessel (1) ist an der Rückseite sichtbar. Nach dem Laden muss das Kabel mit dem Trafo entfernt werden.



Das dauerhafte Laden des Akkus ist zu vermeiden, da es die Lebensdauer des Akkus deutlich negativ beeinflusst.

3. Laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 8 Stunden.
4. Zum Wiederaufladen des integrierten Akkus bitte ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät verwenden. Das Anschlusskabel befindet sich an der Rückseite des Sessels.

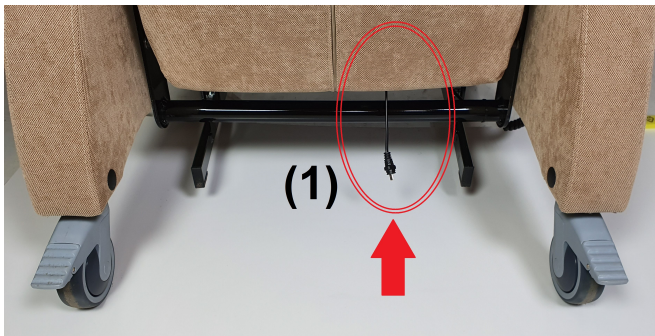

Der Akku sollte spätestens nach 6-monatiger Nichtbenutzung geladen werden. Bei einigen Antriebssystemen kann auch bei Nichtbenutzung ein geringer Strom fließen, der nach längerer Zeit zu einer Entladung führt. Liegt der Akku längere Zeit ungeladen, kann er dadurch geschädigt werden.

Nach längerer Nichtbenutzung kann eine mehrmalige Auf- oder Entladung des Akkus notwendig sein, damit die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird.

Aufgrund der chemischen Reaktion erwärmt sich der Akku beim Aufladen. Besonders deutlich wird dies am Ende des Ladevorgangs. Dann fühlt sich der Akku handwarm an. Wird der Akku jedoch richtig heiß, liegt ein Defekt der Schutzbeschaltung vor. Entfernen Sie in diesem Fall das Ladekabel und lassen Sie die Akku-Einheit von einem autorisierten Fachmann überprüfen.

Benutzen Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.



ACHTUNG: Stellen Sie das Ladegerät nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Das Ladegerät ist nicht spritzwassergeschützt.

Laden Sie den Akku nur im angegebenen Temperaturbereich von 10°C bis 40°C.

Ist der Akku fertig geladen, leuchtet die LED grün. Typischerweise dauert ein Ladezyklus etwa 6 – 8 Stunden.

Aus Sicherheitsgründen das Ladegerät vom Netz trennen, nachdem der Ladevorgang beendet ist.

Die optimale Leistung des Akkus ist dann gegeben, wenn das Produkt unter normalen Raumtemperaturbedingungen (20°C bis 25°C) eingesetzt wird. Die maximale Betriebstemperatur liegt bei 40°C und darf diese nicht überschreiten.

Der Akku entfaltet erst nach ca. 5 bis 10 Lade-/Entladezyklen seine volle Kapazität.

Der Akku ist wartungsfrei.

Bringen Sie den Akku nicht in Kontakt mit organischen Lösungsmitteln, wie zum Beispiel Verdünnung, Alkohol, Öl und Rostschutzmitteln bzw. oberflächenaktiven Mitteln wie chemischen Reinigungsmitteln.

Fehlerbehebung für den Akku

Um die Suche nach üblichen Fehlern und deren Beseitigung zu unterstützen, wurde die nachstehende Tabelle entwickelt. Sollte ein Fehler auftreten, der nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Devita GmbH oder an Ihren Fachhändler. Alle Fehler dürfen nur durch geschulte Personen behoben werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Handscharter Antriebssystem Funktion oder ohne	Handscharter Antriebssystem defekt Keine Netzspannung Akku ist entladen	Wenden Sie sich an Devita GmbH oder an Ihren Fachhändler Netzverbindung herstellen Laden Sie den Akku
Antriebe lassen sich plötzlich nicht mehr verfahren / bewegen	Thermoscharter hat ausgelöst Gerätesicherung hat ausgelöst Zuleitung (Netz und/oder Handscharter /Zusatzantriebe) unterbrochen Akku ist entladen	Das Antriebssystem ca. 20-30 min. in Ruhestellung belassen Wenden Sie sich an Devita GmbH oder an Ihren Fachhändler Zuleitung überprüfen ggf. Kontakt wiederherstellen Laden Sie den Akku
Power ON-LED blinkt	Akku wird geladen	Es liegt kein Fehler vor

7 Pflege, Wartung und Entsorgung



ACHTUNG: Der DEVITA Pflegesessel darf NICHT in explosionsgefährdeten Bereichen betrieben werden.



ACHTUNG: Der Motor darf maximal 2 Minuten unter Nennlast fahren. Danach muss eine Pause von 18 Minuten eingehalten werden. Andernfalls kann es zu einem Funktionsausfall kommen.

Die verwendeten Kunststoffteile sind aus ABS und dürfen nicht mit Benzin, Benzol, Terpentin oder anderen Lösungsmitteln gereinigt werden. Zum Reinigen der Kunststoffteile eignen sich am besten lauwarme Seifenlauge oder handelsübliche Kunststoffreiniger. Die Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Reinigungsmittel sind zu beachten.

Zur Reinigung der Edelstahl-, Stahl- und Holzteile dürfen auf keinen Fall Reinigungsmittel verwendet werden, die Schleifpartikel enthalten. Hier empfehlen wir lauwarmes Seifenwasser und ab und zu die Verwendung eines Holzpflegemittels.

Die Polstermaterialien sind vor starker Hitzeeinwirkung zu schützen. Bei ihrer Reinigung ist darauf zu achten, dass die Polster nicht durchnässt werden. Leichte Verschmutzungen können mit einem feuchten Tuch abgerieben werden. Stärkere Verschmutzungen mit warmer Seifenlauge behandeln, anschließend das Polster trockenreiben.



ACHTUNG: der DEVITA Pflegesessel darf nicht in Waschanlagen oder mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Beim Desinfizieren das Desinfektionsmittel nicht über die vorgeschriebene Einwirkzeit hinaus in das Polster einwirken lassen. Desinfektionsmittel sind aggressiv und können zu einer Veränderung der Oberfläche führen. Desinfektionsmittel nur wie vom Hersteller empfohlen und in der entsprechenden Verdünnung verwenden.

Damit die Funktion der Schwenkrollen sowie anderer beweglicher Bauteile nicht beeinträchtigt wird, sind diese regelmäßig von Schmutz zu befreien, Achsen und Gelenke mit einem Tropfen säurefreiem (z.B. Nähmaschinenöl) oder Fett zu schmieren, Befestigungsschrauben auf festen Sitz zu prüfen.



ACHTUNG: Wartungsarbeiten, die über den beschriebenen Umfang hinaus gehen, dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst oder eingewiesenem Fachpersonal ausgeführt werden.

7.1 Entsorgung

Der DEVITA Pflegesessel, der Akku und das Zubehör sind langlebige Produkte.

Es können jedoch Stoffe enthalten sein, die sich für die Umwelt als schädlich erweisen könnten, falls sie an Orten (z.B. Mülldeponien) entsorgt werden, die nach der aktuellen, im jeweiligen Land gültigen Gesetzgebung dafür nicht vorgesehen sind.

Bitte verhalten Sie sich daher umweltbewusst und führen Sie den DEVITA Pflegesessel am Ende seiner Nutzungsdauer Ihrer regionalen Recyclingeinrichtung zu.

Bitte informieren Sie sich über die in Ihrem Land gültige Gesetzgebung bezüglich der Entsorgung, da die WEEE-Verordnung nicht in allen europäischen Staaten für dieses Produkt Anwendung findet.

7.2 Zusatzinformationen

Vor der Installation bzw. Deinstallation:

- Schalten Sie den Verstellantrieb ab.
- Schalten Sie die Stromzufuhr aus oder ziehen Sie den Netzstecker.
- Entfernen Sie jegliche Last von dem Verstellantrieb.

Während des Betriebs:

- Bei ungewöhnlichen Geräuschen und Gerüchen der Steuereinheit sofort Stromzufuhr abschalten.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden.
- Ziehen Sie das Netzkabel, bevor mobile Teile bewegt werden.
- Die elektrischen Bauteile sind nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen!

Wartung und Pflege:

- Die Werkstoffe widerstehen der überwiegenden Zahl von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, wie sie im Krankenhaus und im häuslichen Pflegebereich verwendet werden.
- Das Reinigen mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger ist nicht erlaubt, weil ein erforderlicher Mindestabstand von 300 mm zu den elektrischen Teilen nicht eingehalten werden kann.

Desinfektions- und Reinigungsmittel:

- Die Mittel dürfen weder einen zu hohen alkalischen noch sauren Wert haben (ph-Wert 6-8).
- Sie dürfen keine ätzenden Bestandteile enthalten. Sie müssen frei von Zusätzen sein, welche die Oberfläche angreifen oder Kunststoffteile auflösen können.
- Sie dürfen Schmierfette nicht angreifen.

Akku-Systeme:

- Häufige und leistungsstarke Entladung verringert die Lebensdauer des Akkus.
- Für eine optimale Lebensdauer muss er so oft wie möglich an die Netzspannung angeschlossen werden.
- Akkus müssen mindestens alle 3 Monate aufgeladen werden – ansonsten werden sie durch Selbstentladung beschädigt.
- Die Funktion der Akkus ist einmal jährlich zu testen
- Akkus dürfen nur durch mechanisch und elektrisch kompatible Typen ersetzt werden. Ersatz erhalten Sie bei DEVITA GmbH oder durch Ihren Vertragshändler.
- Vergewissern Sie sich beim Einbau der Ersatzakkus, dass die Akkus korrekt angeschlossen sind. Überprüfen Sie, dass keine Verbindungen locker sind.
- **ACHTUNG:** In der Fabrik wird der Akkuraum hermetisch vom Elektronikbereich getrennt. Wenn Akkus ersetzt werden, darf diese Trennung nicht beschädigt oder verändert werden, da auf diese Weise Akkugase in den Elektronikbereich eintreten können, was wiederum ein Explosionsrisiko darstellen würde!
- **ACHTUNG:** der Akkuraum ist mit einer Belüftung ausgestattet. Diese darf nicht blockiert oder verdeckt werden, da es durch Überdruck zu einer Explosion kommen könnte.
- Wenn das Akkugehäuse mechanisch überlastet wurde (Fall auf den Boden, Kollision/Pressung in einer Applikation oder kräftiger Schlag), muss es an eine autorisierte Servicewerkstatt zwecks Kontrolle der hermetischen Trennung zwischen Akku- und Elektronikraum gesandt werden.

8 Artikelkennzeichnung

Alle DEVITA Pflegesessel sind mit einem Artikelaufkleber, der folgende Informationen beinhaltet, unterhalb der Sitzfläche gekennzeichnet:

- Fertigungsdatum
- Artikelnummer und Bezeichnung
- AB-Nummer
- Kundennummer

		Poststr. 11 D-66649 Oberthal
Fertigung:	30.11.2011 Made in Germany	
Artikel:	Pflegesessel Narona Lift 2 211.07-20.50	
AB.Nr.:	20113440	
Kunde:	4711 Mustermann	

Teilen Sie diese Daten Ihrem Händler oder unserem Service im Falle einer Beanstandung mit. Je exakter die übermittelten Daten sind, umso besser und zielgerichteter kann Abhilfe geschaffen werden.

9 Übersicht zu den Ersatzteilen

Pos.:	Art.Nr.	Bezeichnung:
Ersatzteile für alle Pflegesessel-Modelle		
01	ET-004	Motor für Rücken
02	ET-003	Motor für Beinteil
03	ET-002	Motor für Aufstehfunktion
04	ET-001	Netzkabel mit Stecker für Netzteil
05	ET-005	Netzteil
06	ET-006	Akku
07	ET-101	Handschalter
08	ET-102	Schwenkrolle mit Bremse D100 First
09	ET-103	Schwenkrolle ohne Bremse D100 First

10 Gewährleistung und Haftung

10.1 Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit für den DEVITA Pflegesessel beträgt 24 Monate (für Akkus 6 Monate) ab Kaufdatum und erstreckt sich auf Material- und Verarbeitungsfehler, nicht auf Verschleißteile.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Verschleißteile
- Schäden, die sich infolge unsachgemäßer Behandlung ergeben
- gewaltsame Beschädigungen
- unzulässige Änderungen am DEVITA Pflegesessel oder an den Zusatzteilen.

Im Einzelnen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Devita GmbH.

10.2 Haftung

Die Devita GmbH ist als Hersteller des DEVITA Pflegesessels für dessen Sicherheit nicht verantwortlich, wenn

- der DEVITA Pflegesessel unsachgemäß gehandhabt wird.
- der DEVITA Pflegesessel entgegen den Hinweisen dieser Bedienungsanleitung in Betrieb genommen wird.
- Reparaturen oder andere Arbeiten von nicht autorisierten Personen durchgeführt werden.
- fremde Teile angebaut oder mit dem DEVITA Pflegesessel verbunden werden.
- Teile des DEVITA Pflegesessels ab- oder umgebaut werden.

11 Konformitätserklärung

Der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebene DEVITA Pflegesessel wurde unter Beachtung der aktuell geltenden Anforderungen und Vorschriften konstruiert und gefertigt.



Die Gültigkeit der Konformitätserklärung erlischt, wenn durch den Kunden oder Dritte Änderungen an dem Produkt vorgenommen werden, zum Beispiel Umbauten aller Art, Verwendung fremden Zubehörs, Entfernen von Warn- und Hinweisschildern.